


# CAPTURADOR DE IMÁGENES TRAUMATOLÓGICAS

## CARACTERÍSTICAS

- Equipo digitalizador de rayos-X veterinario
- Tamaño de placas 43x33cm
- Camilla de acero 1m x 50cm x 75cm (con posibilidad de expansión longitudinal)
- Software de adquisición de datos propietario (Ultrason)
- Alimentación red eléctrica 220v
- Conexión wifi para envío de estudio y radiografías
- Conexión USB para paso de información mediante pen-drive
- Teclado y mouse USB
- Pantalla LCD/Led HMDI estándar

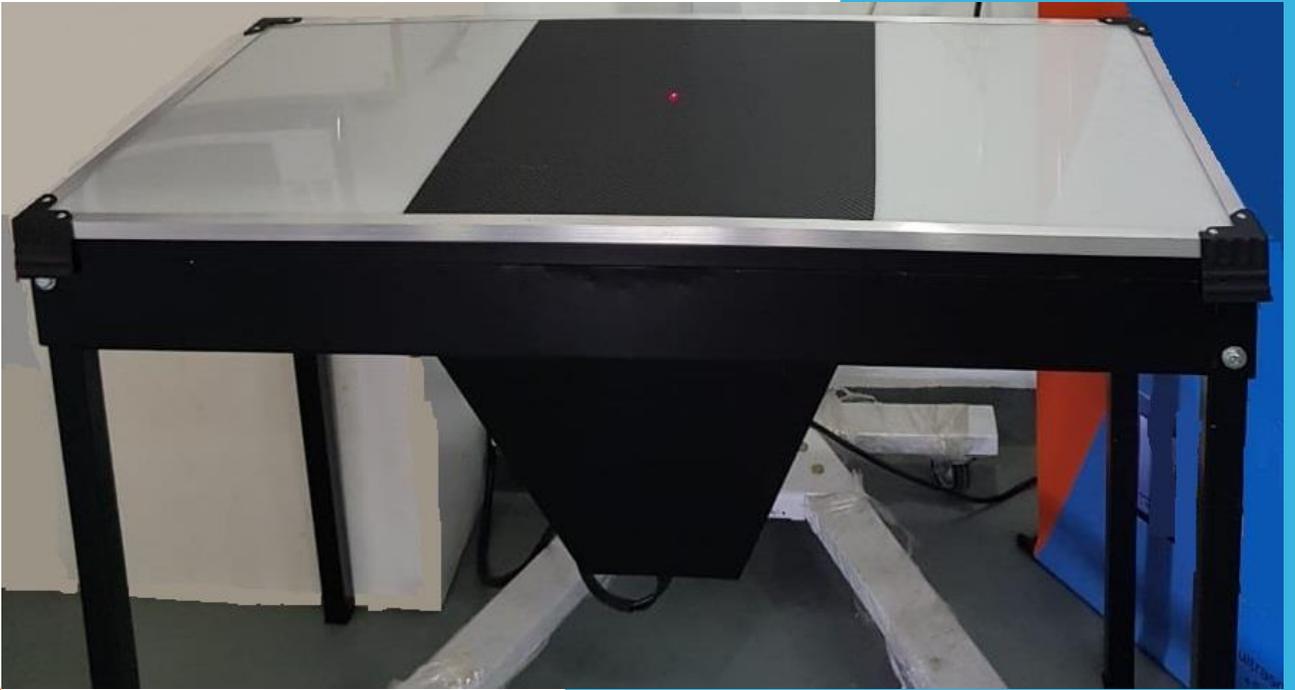

Contacto:  
ultrason\_@hotmail.com  
+54 9 351 679-8640  
Facebook: Ultrason Electromedicina